

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 84401959.6

(51) Int. Cl.⁴: **A 61 B 8/12**
G 10 K 11/00

(22) Date de dépôt: 01.10.84

(30) Priorité: 29.09.83 FR 8315522

(43) Date de publication de la demande:
02.05.85 Bulletin 85/18

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Demandeur: Fornage, Bruno Denis Lucien
Tramery
F-51170 Fismes(FR)

(71) Demandeur: Pourcelot, Léandre
14, rue G. Guynemer Saint-Avertin
F-37170 Chambray-les Tours(FR)

(72) Inventeur: Fornage, Bruno Denis Lucien
Tramery
F-51170 Fismes(FR)

(72) Inventeur: Pourcelot, Léandre
14, rue G. Guynemer Saint-Avertin
F-37170 Chambray-les Tours(FR)

(74) Mandataire: Robert, Jean-Pierre et al,
Cabinet Armengaud Jeune Casanova et Lepeudry 23,
boulevard de Strasbourg
F-75010 Paris(FR)

(54) Perfectionnement aux sondes d'échographie médicale endocavitaire.


(57) L'invention concerne une sonde d'échographie ultrasonore d'examen par voie endocavitaire pour délivrer au moins deux images tomographiques complémentaires qui comporte :

- un support (1) longitudinal sensiblement cylindrique
- une pluralité de cristaux élémentaires, disposés sensiblement le long d'une génératrice dudit support (1), formant un capteur (2) à balayage électronique linéaire,
- un capteur à balayage mécanique, monté à rotation en (3) par rapport au support (1), autour de son axe longitudinal, et connecté à un organe d'entraînement de sa rotation par un organe de transmission,

- des moyens de connexion électriques ou électroniques de chacun des capteurs s'étendant à l'intérieur dudit support, depuis ces derniers jusqu'à d'une part un générateur et, d'autre part, à un appareil (9, 10) de visualisation des signaux recueillis.

Application à l'industrie de l'appareillage médical.

EP 0 139 574 A2

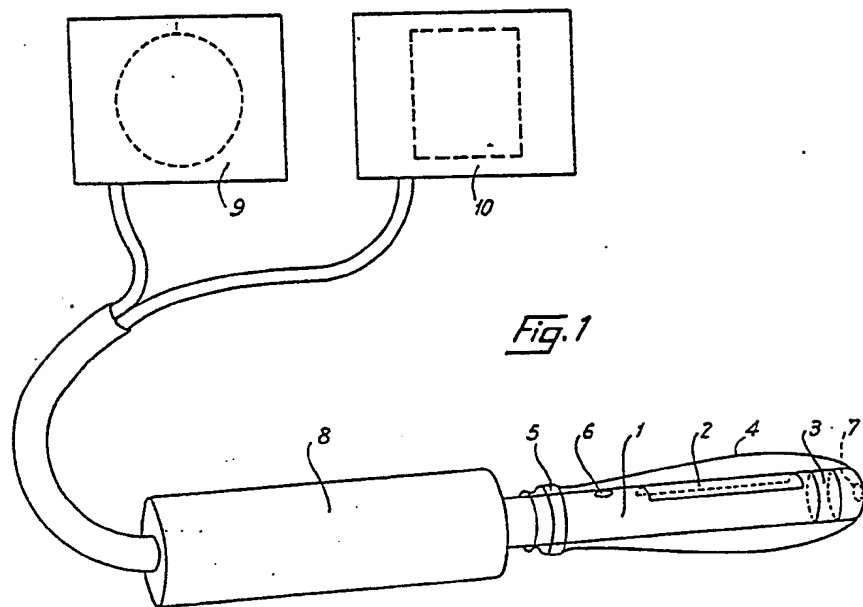

Perfectionnement aux sondes d'échographie médicale endocavitaire.

La présente invention concerne une sonde d'échographie ultrasonore capable de fournir à l'opérateur, au cours d'une même manipulation, deux images tomographiques complémentaires d'une même région d'un corps entourant une cavité dans laquelle est introduite la sonde, ce corps creux pouvant être un liquide ou un solide inerte ou un corps vivant humain ou animal.

Dans le domaine médical le matériel existant, pour l'exploration endocavitaire par ultrasons, se divise en deux types de sondes.

Il s'agit tout d'abord de sondes endocavitaires à balayage mécanique. L'élément essentiel de ces sondes réside dans un capteur pouvant tourner ou osciller autour d'un axe parallèle à ou confondu avec l'axe longitudinal de la sonde. Le champ exploré est défini par la surface engendrée, lors de la rotation du capteur, par son axe ultrasonore qui peut être soit orthogonal à l'axe de sa rotation soit incliné sur celui-ci. Ainsi cette surface est soit plane soit conique. Le champ exploré peut dans cette surface, être limité par l'amplitude de la rotation du capteur à un secteur angulaire déterminé ou au contraire s'étendre sur la totalité de cette surface.

On connaît également des sondes constituées par une pluralité de cristaux ou transducteurs élémentaires s'étendant sensiblement le long d'une génératrice de la sonde, c'est-à-dire parallèlement à son axe longitudinal. Cette pluralité de cristaux forme un capteur dit à balayage électronique linéaire ou sectoriel. La surface explorée est alors constituée par un plan, ou une portion

rectangulaire de plan, passant par l'axe de la sonde.
On peut ouvrir le champ exploratoire qui devient alors
un secteur de plan plus ouvert que la portion rectangu-
laire susdite, soit par l'emploi d'une sonde légèrement
5 incurvée portant à sa partie convexe ladite pluralité de
cristaux, soit à partir d'un arrangement plan de trans-
ducteurs élémentaires, par déphasage des signaux élec-
triques d'émission et de réception de chaque transduc-
teur.

10 On notera que dans ces deux types de sondes,
les capteurs sont disposés à la partie terminale d'un
support relativement rigide, le plus souvent cylindrique,
destiné à assurer la mise en place et le déplacement des
capteurs à l'intérieur de la cavité, notamment vaginale ou
15 rectale à explorer.

Chaque sonde ne fournit qu'un seul type d'image
soit contenant l'axe de la sonde, soit sécant avec cet
axe. Or l'utilisation de l'échographie dans le diagnostic
médical requiert fondamentalement une représentation tomo-
20 graphique exhaustive des organes à l'aide de plans de coupe
différents. Le minimum requis est de deux plans de coupe
orthogonaux. La satisfaction de cette exigence implique,
avec les dispositifs connus, le recours à l'introduction
successive de deux sondes différentes pour obtenir, successi-
25 vement dans le temps, les deux images tomographiques complé-
mentaires.

Les inconvénients de l'utilisation de deux
sondes successives résident d'une part dans l'inconfort pour
le patient et d'autre part dans la nécessité de choisir
30 et conserver des informations recueillies par la première
sonde pour pouvoir effectuer une comparaison avec celles
fournies par la seconde sonde.

La présente invention se propose de pallier
ces inconvénients par le moyen d'une sonde unique. Cette
35 sonde offre, outre les avantages de chacun des deux types
rappelés ci-dessus, la possibilité d'une meilleure approche
des organes dans l'espace et un repérage topographique
optimal des lésions, contribuant ainsi au choix de la meil-
leure stratégie thérapeutique.

A cet effet, l'invention a pour objet une sonde d'échographie ultrasonore d'examen par voie endocavitaire, pour délivrer au moins deux images tomographiques complémentaires. Cette sonde comporte :

- 5 - un support longitudinal sensiblement cylindrique,
- une pluralité de transducteurs élémentaires disposés sensiblement le long d'une génératrice dudit support et formant un premier capteur à balayage électronique linéaire, ou sectoriel d'un premier plan d'exploration,
- 10 - un second capteur dont le faisceau ultrasonore est orienté selon une surface sécante du premier plan d'exploration susdit
- et des moyens de connexion électriques, électroniques ou mécaniques de chacun des capteurs s'étendant, à l'intérieur dudit support, depuis ces derniers jusqu'à d'une
- 15 part, un générateur et d'autre part, un appareil de visualisation des signaux recueillis.

Dans un premier mode de réalisation, le premier capteur à balayage électronique est constitué par un arrangement plan de transducteurs élémentaires commandés par un

20 dispositif électronique destiné à déphaser les signaux électriques d'émission et de réception pour réaliser un balayage électronique sectoriel.

Dans une variante de ce mode de réalisation, ledit capteur à balayage électronique est constitué par un

25 arrangement courbe de transducteurs élémentaires commandés par un dispositif électronique destiné à réaliser un balayage le long du support aboutissant à une déflexion angulaire du faisceau ultrasonore.

30 Par ailleurs, dans un mode de réalisation du second capteur, ce dernier est à balayage mécanique et constitué par un transducteur tournant dont l'axe ultrasonore est sensiblement perpendiculaire à son axe de rotation.

35 Dans une variante le capteur à balayage mécanique est constitué par un transducteur fixe, d'axe ultrasonore longitudinal, associé à un miroir acoustique tournant

autour de l'axe longitudinal du support, d'inclinaison réglable sur cet axe et attelé audit organe de transmission.

Un autre mode de réalisation du second capteur réside dans un arrangement plan de transducteurs élémentaires le long d'une direction sensiblement perpendiculaire à celle de l'arrangement du premier capteur et commandés électroniquement de manière à obtenir un balayage sectoriel par déphasage des signaux électriques d'émission et de réception.

On notera que ce second capteur peut être coplanaire au premier ou dans un plan formant un angle avec le plan du premier capteur.

Une variante de cet autre mode de réalisation consiste en un second capteur formé d'un arrangement courbe de transducteurs élémentaires le long d'une direction perpendiculaire à celle du premier capteur, commandés électroniquement pour réaliser un balayage transversal au support. On obtient alors une déflexion angulaire du faisceau ultrasonore.

L'invention sera mieux comprise au cours de la description donnée ci-après à titre d'exemple purement indicatif et non limitatif qui permettra d'en dégager les avantages et les caractéristiques secondaires.

Il sera fait référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma général de la sonde selon l'invention,
- la figure 2 illustre par un schéma, un premier mode de réalisation de celle-ci, dans lequel le second capteur est à balayage mécanique,
- la figure 3 représente une variante de réalisation de la figure 2,
- la figure 4 est le schéma d'une variante de réalisation de la figure 3,
- la figure 5 est une représentation schématique d'un troisième mode de réalisation de l'invention,

- la figure 6 illustre par un schéma les différentes surfaces balayées par la sonde selon l'invention,

- les figures 7, 8 et 9 illustrent schématiquement des sondes dans lesquelles le second capteur est un arrangement de transducteurs élémentaires commandés électroniquement.

En se reportant tout d'abord à la figure 1, on voit une sonde constituée par un support 1 sensiblement cylindrique. Ce support, relativement rigide, est équipé d'une série de cristaux élémentaires 2 le long d'une de ses génératrices. Ces cristaux constituent un capteur à balayage électronique, connu en lui-même, qui permet d'explorer un demi-plan passant sensiblement par l'axe du support 1. ce capteur s'étend sur la plus grande partie du support 1 tout en étant plutôt décalé vers sa zone distale. Au-delà de ce capteur, au voisinage de l'extrémité libre du support, on a représenté en 3 la zone dans laquelle est placé un second capteur ultrasonore capable d'explorer un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe longitudinal du support par le moyen d'un balayage mécanique c'est-à-dire par rotation de l'axe ultrasonore du capteur perpendiculaire à l'axe longitudinal du support. Ce capteur de la zone 3 sera illustré plus en détail en regard des figures 2 à 4. L'ensemble du support 1, du capteur 2 et de la zone 3 est encapsuchonné par un embout extérieur non représenté, qui protège les capteurs tout en constituant la forme extérieure du support, donc de la zone active de la sonde.

Le support comporte également une enveloppe 4 déformable, dans laquelle il est logé de manière étanche grâce à une collerette de fixation 5. Le volume intérieur de cette enveloppe peut être purgé ou alimenté en eau, au moyen de conduits disposés dans le support 1 et débouchant en 6 et 7 à sa surface.

Le support se prolonge d'une poignée 8 de manipulation permettant son introduction et son orientation dans la cavité à explorer, ainsi que la modification de cette orientation. Cette poignée comporte des boutons de

commande du fonctionnement de la sonde ainsi que des index de rappel de l'orientation du capteur à balayage électronique linéaire.

Les connexions électriques et électroniques des capteurs 2 et de la zone 3 sont réalisés au moyen d'un câblage de connexion, s'étendant à l'intérieur du support 1, pour relier lesdits capteurs d'une part, à une source d'excitation des transducteurs qui forment les capteurs pour émettre par effet piézo-électrique les ultrasons et d'autre part, à un système de visualisation des signaux délivrés par les capteurs lorsqu'ils fonctionnent en récepteurs des échos ultrasoniques. Ce système de visualisation est représenté en 9 sur la figure 1 pour le capteur à balayage mécanique situé dans la zone 3 de la sonde et en 10 pour le capteur à balayage électronique linéaire. Il s'agira de préférence d'une visualisation vidéo.

Sur la figure 2 on retrouve certains des éléments de la figure 1 avec les mêmes références. On voit qu'ici le capteur à balayage mécanique est constitué par un transducteur 11 calé sur un arbre 12, susceptible d'être animé d'un mouvement de rotation au moyen d'un organe d'entraînement non représenté. Cet arbre 12 sera de préférence creux de manière que les conducteurs électriques puissent être logés à l'intérieur de celui-ci.

L'arbre 12 peut être soit rigide, dans le cas où une poignée de manipulation est disposée à proximité du support 1, le moteur étant alors logé dans cette poignée, soit souple et simplement guidé rigidement à l'intérieur du support 1 au niveau du capteur à balayage électronique linéaire 2. Cet arbre souple de transmission permet de disposer la sonde selon l'invention à l'extrémité d'un appareil du type endoscope, pour explorer des cavités éloignées de leur ouverture naturelle d'accès.

Par ailleurs on pourra prévoir que le transducteur 11 est brochable de manière amovible à l'extrémité de l'arbre 12, ce qui permettra son interchangeabilité et ainsi de choisir le transducteur le mieux adapté à l'examen considéré.

Sur cette figure 2 on a également représenté le capuchon 13 évoqué en regard de la figure 1. Ce capuchon est amovible.

Ce n'est pas sortir du cadre de l'invention
5 que de placer le transducteur tournant 11 entre deux séries égales et alignées de cristaux, qui forment le capteur à balayage électronique linéaire. Cette disposition offre l'avantage d'avoir des surfaces d'exploration par chacun des capteurs, toujours sécantes. Dans ce cas il est
10 nécessaire de prévoir une synchronisation de l'activation des deux capteurs de manière à éviter que les signaux émis ou réfléchis de l'un viennent en interférence avec ceux de l'autre.

Sur la figure 3 on a représenté une variante de
15 réalisation du capteur à balayage mécanique. Celui-ci est, dans cet exemple, constitué par un transducteur fixe 14 dont l'axe ultrasonore est parallèle à l'axe du support 1. Ce transducteur est associé à un miroir acoustique 15
monté à rotation sur l'arbre de transmission 12. Ce miroir
20 étant à 45°, le champ exploré est perpendiculaire à l'axe du support 1. On peut prévoir l'attelage du miroir 15 à l'arbre de transmission 12 réglable en inclinaison, de manière à transformer le champ exploré en une pluralité de surfaces coniques. De même que dans la figure précédente, le capteur à balayage
25 mécanique constitué par le transducteur 14 et le miroir 15, peut être inséré au milieu du capteur à balayage électronique 2.

La figure 4, qui est une variante de réalisation de la figure 3, montre que le transducteur 14 fixe est situé
30 entre le capteur à balayage électronique linéaire 2 et le miroir 15, contrairement à la disposition de la figure 3. Ainsi le miroir 15 peut être directement attelé en rotation à l'arbre de sortie d'un moteur 16 situé en partie distale de la sonde.

35 Sur la figure 5 on a représenté une sonde dont le support 1 est légèrement incurvé, avec un grand rayon de courbure, de manière que le capteur à balayage électronique linéaire 2 couvre, non plus une portion rectangulaire

de plan, mais un secteur de plan. Cette disposition permet d'augmenter le champ exploratoire couvert par ce capteur 2.

Sur cette figure 5 comme sur la figure 6 on a représenté schématiquement les surfaces explorées respectivement par le capteur à balayage électronique linéaire 2 et le capteur à balayage mécanique situé dans la zone 3. On voit sur ces figures, que lorsque le capteur à balayage mécanique engendre une surface d'exploration conique, dirigée vers l'arrière de la sonde, cette surface vient en intersection avec la surface explorée par le capteur à balayage électronique linéaire. La trace de cette intersection dans le plan couvert par le capteur 2 est représentée par la ligne 17. Cette intersection peut, par manipulation de la sonde, être placée précisément dans la zone à examiner dont on aura une image visualisée selon deux surfaces sensiblement orthogonales par les deux systèmes de visualisation 9 et 10. Les images ainsi recueillies permettront une évaluation beaucoup plus précise de l'étendue de la tumeur ou de la lésion examinée.

Le dispositif décrit ci-dessus en regard des figures 1 à 6 fait appel à une combinaison de deux capteurs à balayage mécanique d'une part et électronique d'autre part. Dans certaines applications cependant, il peut être avantageusement constitué par la combinaison de deux capteurs à balayage électronique.

Les figures 7, 8 et 9 illustrent des dispositifs possédant deux ensembles de transducteurs disposés de manière à fournir deux plans de balayage perpendiculaires.

Ainsi sur la figure 7 on retrouve une série 2 (ou barrette) de transducteurs élémentaires qui permet au moyen d'une commutation électronique en commande de procéder au balayage du plan d'exploration 20. Une seconde série 21 de transducteurs est disposée à l'extrémité de la sonde dans un plan légèrement relevé par rapport au plan contenant la barrette 2. Au moyen d'une commande par déphasage électronique on peut balayer un secteur de plan 22 dont l'intersection avec le plan 20 est marquée

par la ligne 27. Cette intersection étant placée dans la zone à explorer, on peut obtenir de cette zone une imagerie avantageuse en deux plans comme indiqué précédemment.

5 La figure 8 montre que l'on peut associer à une barrette courbe longitudinale, semblable à celle de la figure 5, une barrette courbe transversale 23. Les deux barrettes balayent respectivement les deux secteurs de plan 24 et 25 qui se coupent selon la ligne 27. Dans ce cas de figure il suffit de commander le balayage par
10 commutation électronique pour néanmoins obtenir un balayage angulaire.

A la figure 9 enfin on a représenté deux barrettes planes 2 et 26 sensiblement perpendiculaires. Grâce à un déphasage électronique introduit dans leur
15 commande, on réalise un balayage sectoriel dans les deux plans 28 et 29 se coupant le long de la ligne 27.

On notera que comme en regard des figures 2 à 6, le second capteur peut être logé à l'extrémité distale de la sonde ou logé entre deux portions de barrette
20 longitudinale.

Il est possible grâce à l'invention d'obtenir une imagerie selon deux directions des zones examinées et ce soit alternativement soit simultanément.

En outre dans les diverses combinaisons décrites, il est possible d'étudier la variation de fréquence par effet Doppler des ondes ultrasonores réfléchies afin d'effectuer des mesures de vitesse d'écoulement des liquides (sang, urines...). On peut accéder à la mesure de débit, si l'image permet de déterminer le
25 diamètre des conduits (artère, urètre...) dans lesquels circulent les fluides.
30

L'invention trouve une application non seulement dans le domaine médical mais également dans le domaine industriel pour l'exploration de solides ou liquides
35 dans lesquels on peut introduire la sonde.

REVENDEICATIONS

1.- Sonde d'échographie ultrasonore d'examen par voie endocavitaire pour délivrer au moins deux images tomographiques complémentaires, caractérisée en ce qu'elle comporte :

- 5 - un support (1) longitudinal sensiblement cylindrique,
- une pluralité de transducteurs élémentaires, disposés sensiblement le long d'une génératrice dudit support (1), formant un premier capteur (2) à balayage électronique d'un premier plan d'exploration,
- 10 - un second capteur (3, 11, 14, 15, 21, 25, 26) dont le faisceau ultrasonore est orienté selon une surface sécante du premier plan d'exploration susdit,
- des moyens de connexion électriques, électroniques et mécaniques, chacun des capteurs s'étendant à l'intérieur
- 15 dudit support, depuis ces derniers jusqu'à d'une part un générateur et, d'autre part, à un appareil (9), (10) de visualisation des signaux recueillis.

2.- Sonde selon la revendication 1, caractérisée en ce que le premier capteur (2) susdit est constitué par

20 un arrangement plan de transducteurs élémentaires commandés électroniquement de manière à déphaser les signaux électriques d'émission et de réception pour réaliser un balayage électronique sectoriel (28).

3.- Sonde selon la revendication 1, caractérisée

25 en ce que le premier capteur (2) est constitué par un arrangement courbe de transducteurs élémentaires dont la commande par commutation électronique permet de réaliser un balayage (24) le long du support aboutissant à une déflexion angulaire du faisceau ultrasonore.

30 4.- Sonde selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le second capteur susdit est constitué par un arrangement plan de transducteurs élémentaires (21, 26) commandés électro-

35 niquement de manière à déphaser les signaux électriques d'émission et de réception pour réaliser un balayage électronique sectoriel (22, 28).

5.- Sonde selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le second capteur susdit est constitué par un agencement courbe (26) de transducteurs élémentaires dont la commande par commutation électronique permet de réaliser un balayage (25) le long du support aboutissant à une déflexion angulaire du faisceau ultrasonore.

6.- Sonde selon la revendication 1, caractérisée en ce que le second capteur est à balayage mécanique et est constitué par un transducteur (11) tournant, dont l'axe ultrasonore est sensiblement perpendiculaire à son axe de rotation (12).

7.- Sonde selon la revendication 1, caractérisée en ce que le capteur est à balayage mécanique susdit et est constitué par un transducteur fixe (14) d'axe ultrasonore longitudinal, associé à un miroir acoustique (15) tournant autour de l'axe longitudinal du support (1), d'inclinaison réglable sur ledit axe, et attelé audit organe (12) de transmission.

8.- Sonde selon la revendication 7, caractérisée en ce que ledit miroir (15) est disposé entre le capteur à balayage électronique linéaire (2) et le transducteur (14).

9.- Sonde selon la revendication 7, caractérisée en ce que le miroir (15) susdit est situé au-delà dudit transducteur (14) par rapport audit capteur à balayage électronique (2) et en ce que l'organe de transmission et l'organe d'entraînement (16) du miroir (15) sont situés au-delà de ce dernier.

10.- Sonde selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le second capteur est disposé en position distale (3) de la sonde par rapport au capteur à balayage électronique linéaire (2).

11.- Sonde selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le second capteur est disposé entre deux parties alignées du capteur à balayage électronique linéaire (2).

12.- Sonde selon l'une quelconque des revendications 4 à 8 , 10 et 11, caractérisée en ce que l'organe de transmission (12) du capteur à balayage mécanique (11, 14, 15) est un arbre rigide et en ce que l'organe d'entraînement est situé dans une poignée (8) de manipulation de la sonde solidaire du support susdit et pourvu des commandes dudit organe d'entraînement.


13.- Sonde selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, 10 et 11, caractérisée en ce que l'élément de transmission (12) est souple et est guidé rigidement dans le support (1) au voisinage du capteur à balayage électronique linéaire (2).





14.- Sonde selon la revendication 10, caractérisée en ce que le capteur à balayage mécanique (11) est connecté de manière amovible à l'organe de transmission (12).

15.- Sonde selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'au moins le capteur à balayage mécanique est recouvert d'un capuchon (13) rigide et amovible conférant à la sonde sa forme extérieure.

16.- Sonde selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le support et les capteurs sont contenus dans une enveloppe (4) souple et déformable, dans laquelle débouchent des canalisations (6) et (7) de remplissage et de purge de son volume intérieur ménagées dans ledit support.

1/4

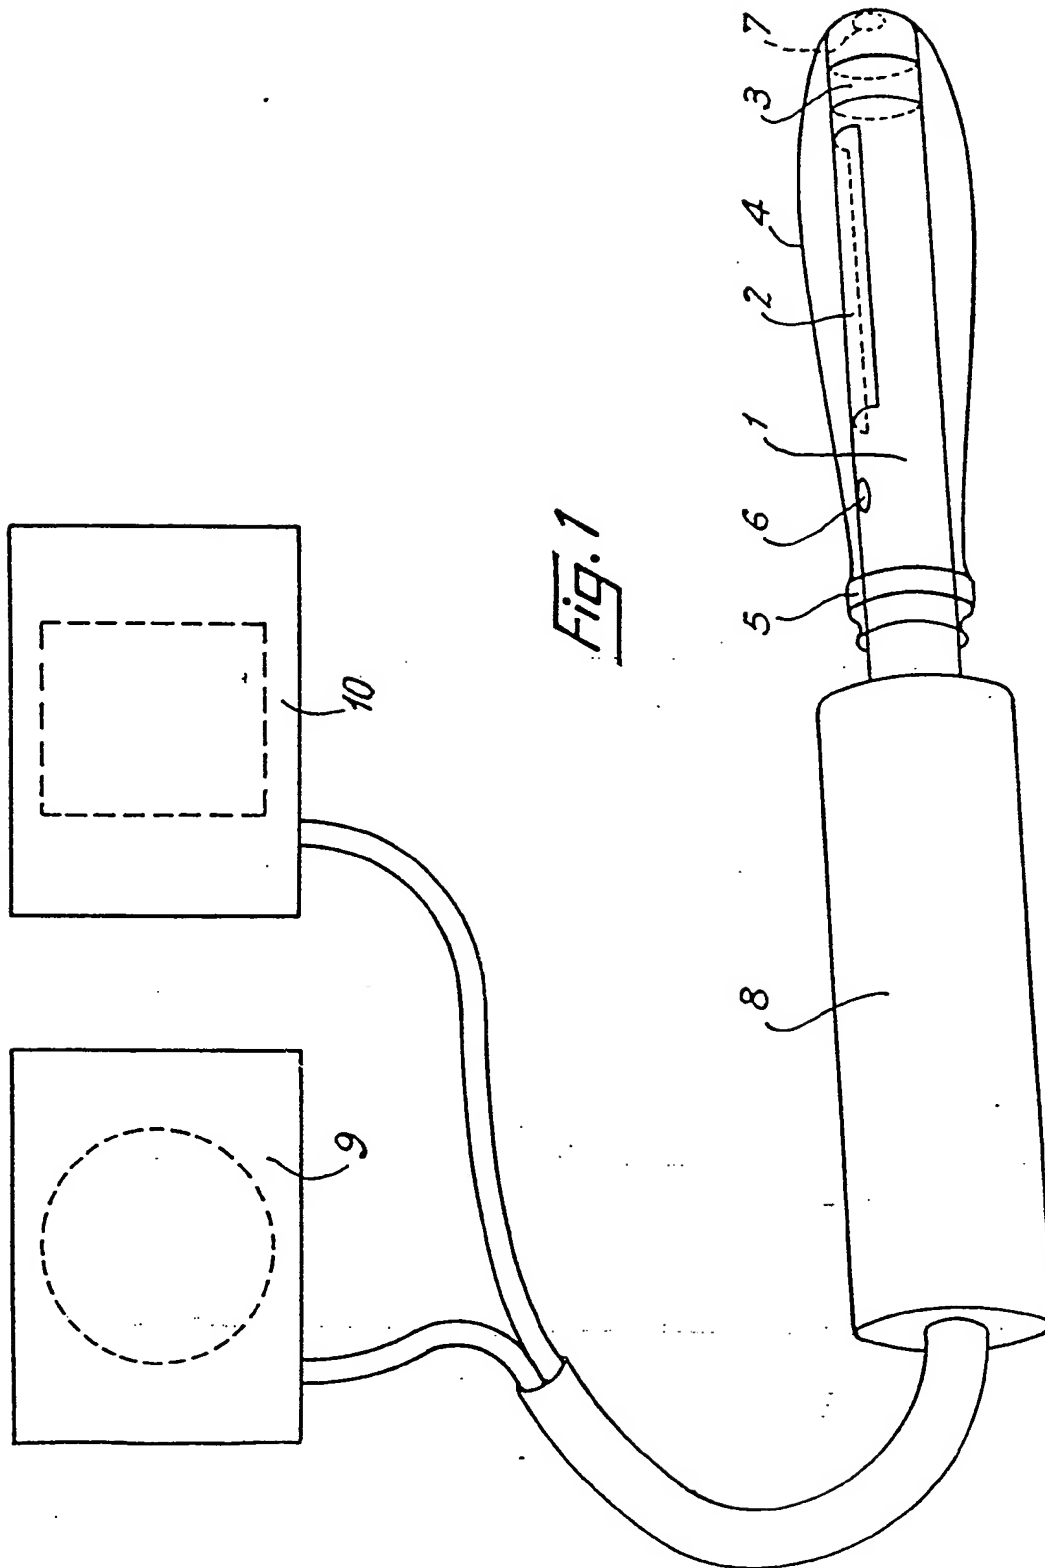

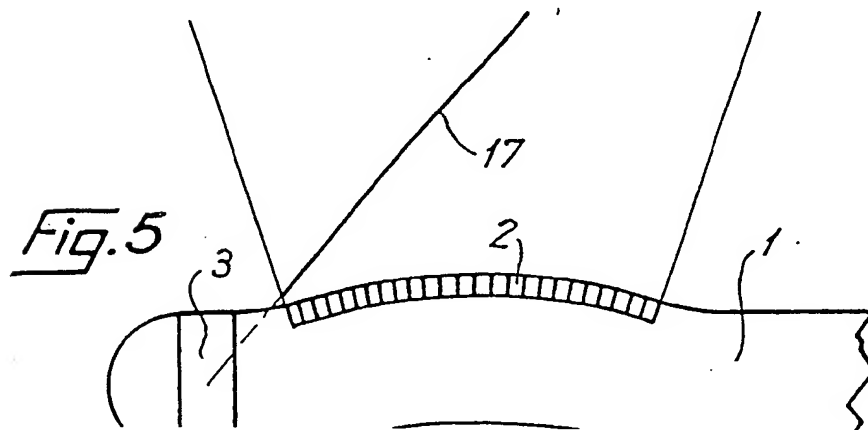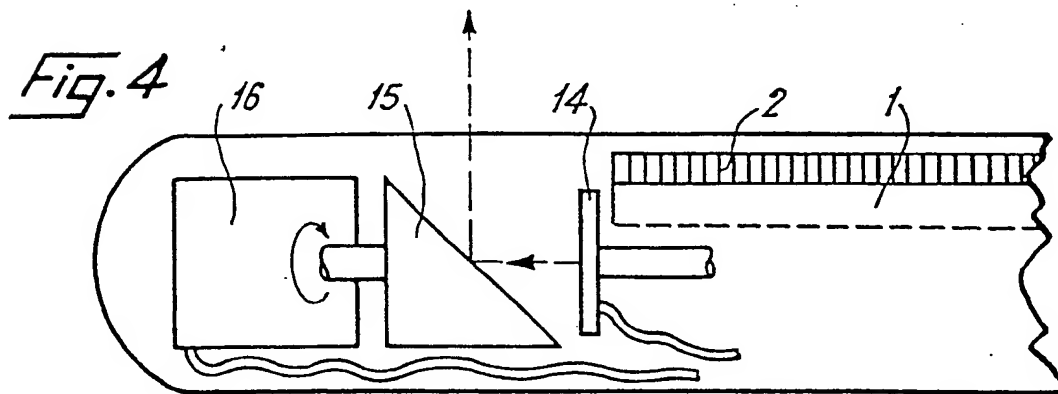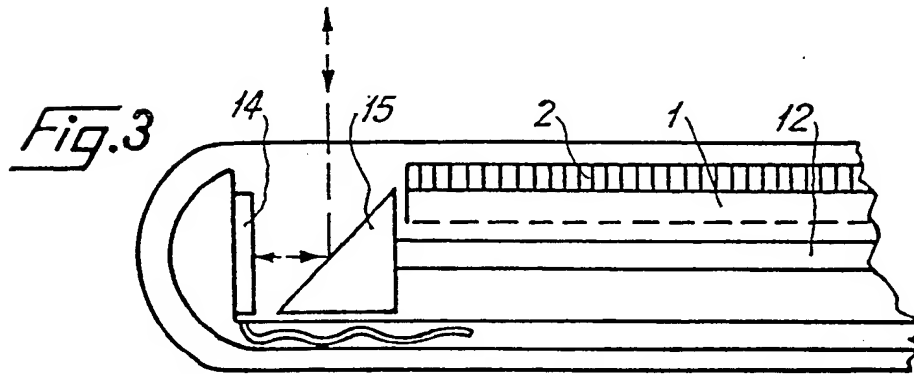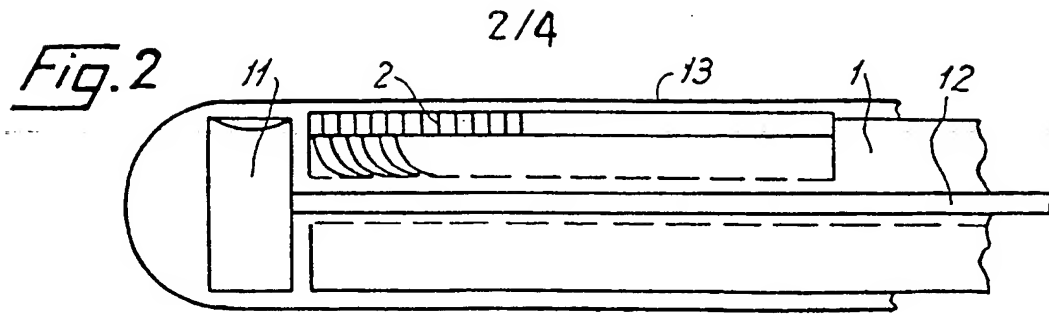

3/4

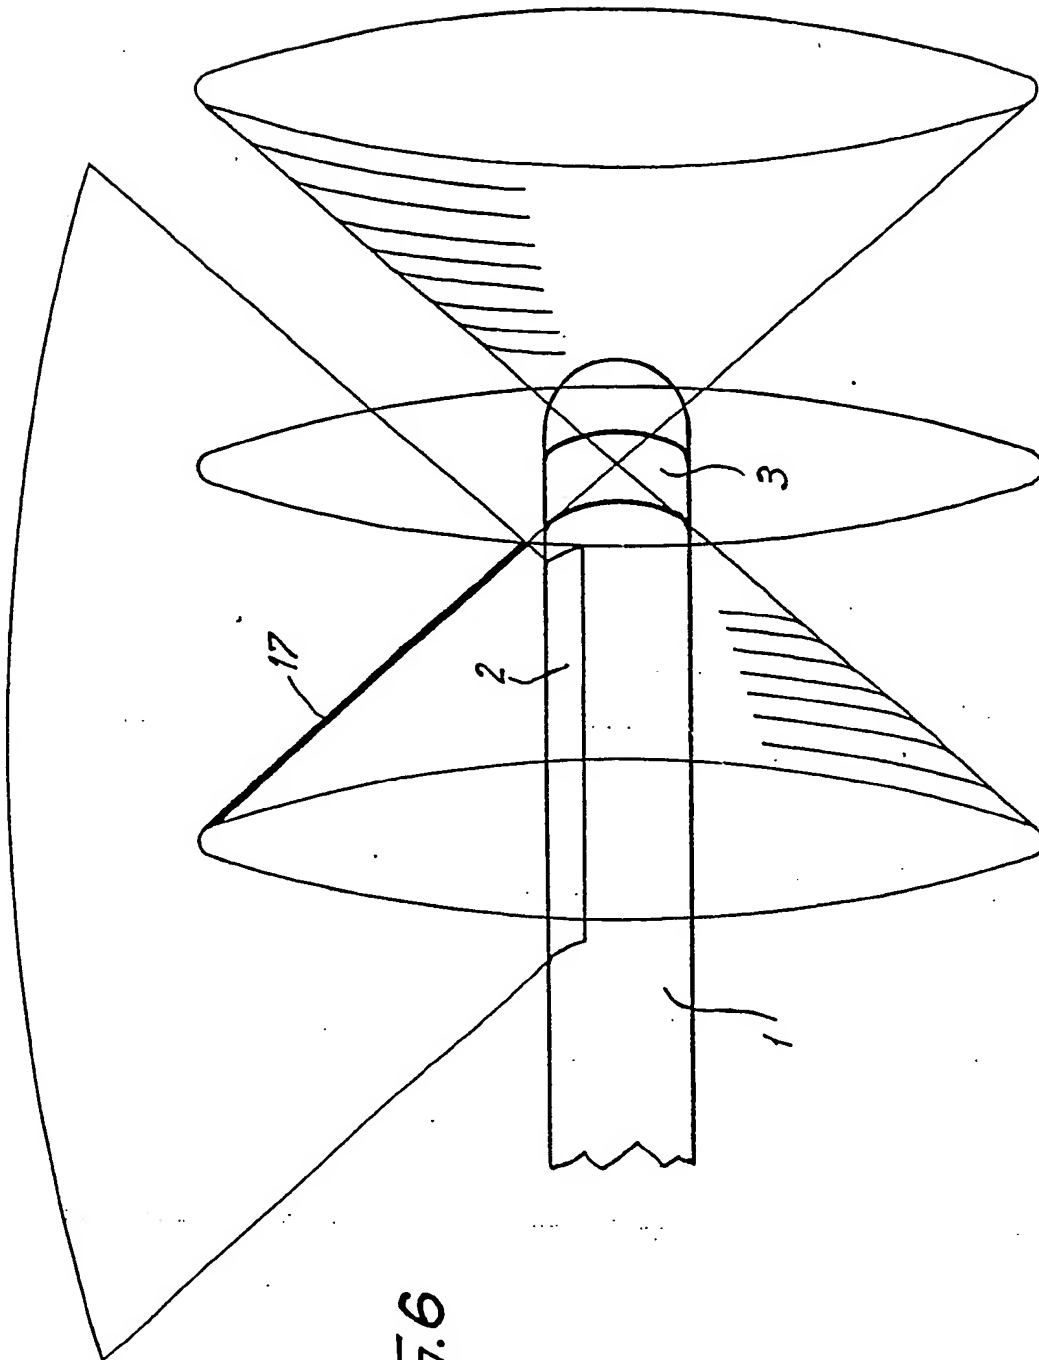


Fig. 6

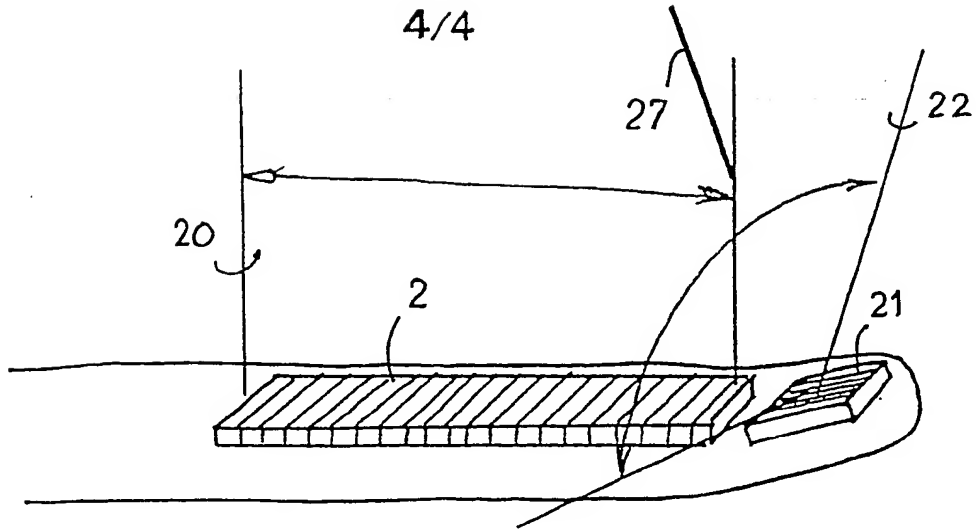


Fig. 7

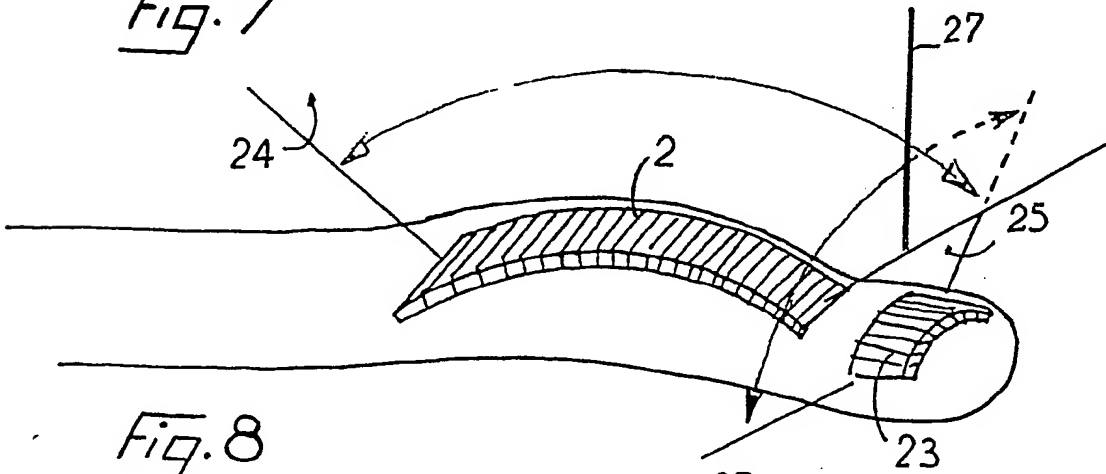


Fig. 8

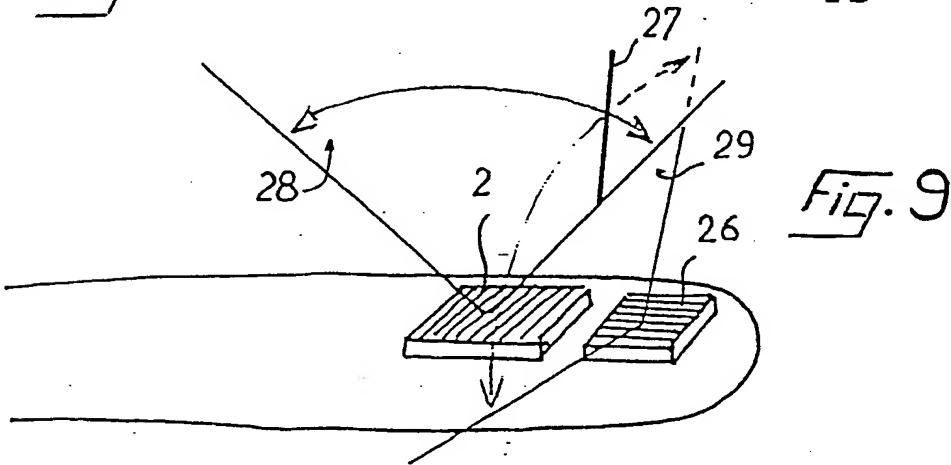


Fig. 9

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 84401959.6

(51) Int. Cl.⁴: **A 61 B 8/12**
G 10 K 11/00

(22) Date de dépôt: 01.10.84

(30) Priorité: 29.09.83 FR 8315522

(43) Date de publication de la demande:
02.05.85 Bulletin 85/18

(88) Date de publication différée du rapport de
recherche: 19.06.85

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Demandeur: Fornage, Bruno Denis Lucien
Tramery
F-51170 Fismes(FR)

(71) Demandeur: Pourcelot, Léandre
14, rue G. Guynemer Saint-Avertin
F-37170 Chambray-les Tours(FR)

(72) Inventeur: Fornage, Bruno Denis Lucien
Tramery
F-51170 Fismes(FR)

(72) Inventeur: Pourcelot, Léandre
14, rue G. Guynemer Saint-Avertin
F-37170 Chambray-les Tours(FR)

(74) Mandataire: Robert, Jean-Pierre et al,
Cabinet Armengaud Jeune Casanova et Lepeudry 23,
boulevard de Strasbourg
F-75010 Paris(FR)


(54) Perfectionnement aux sondes d'échographie médicale endocavitaire.

(57) Une sonde d'échographie ultrasonore d'examen par
voie endocavitaire pour délivrer au moins deux images
tomographiques complémentaires comporte :

- un support (1) longitudinal sensiblement cylindrique
- une pluralité de cristaux élémentaires, disposés sensiblement le long d'une génératrice du support (1), formant un capteur (2) à balayage électronique linéaire, et
- un capteur à balayage mécanique (11),

connecté à un organe d'entraînement (12) en rotation autour de son axe longitudinal.

Des moyens de connexion électriques s'étendent à l'intérieur du support, depuis chacun des capteurs jusqu'à, d'une part, un générateur et, d'autre part, un appareil (9, 10) de visualisation des signaux recueillis.

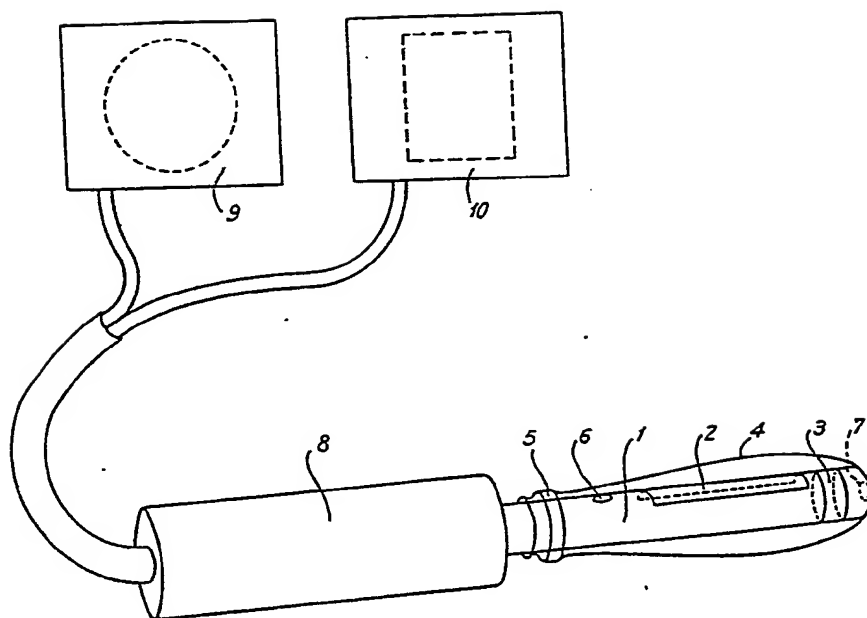



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS															
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)												
Y	FR-A-2 507 075 (SRI INTERNATIONAL) * Page 2, lignes 15-25; page 8, lignes 9-18; page 10, lignes 34-38; page 11, ligne 31 - page 12, ligne 14; page 15, lignes 13-25; figures 1-5 *	1,2	A 61 B 8/12 G 10 K 11/00												
Y	WO-A-8 300 009 (COMMONWEALTH OF AUSTRALIA) * Abrégé; page 7, lignes 14-23; page 9, lignes 30-35; page 11, lignes 24-29; page 13, lignes 3-5, 20-30; figure 1 *	1,2													
A		3,6													
A	GB-A-2 073 418 (GOVERNING COUNCIL UNIVERSITY OF TORONTO) * Abrégé; page 1, lignes 70-79, 114-129; page 2, lignes 5-10, 31-34, 43-56; figures 1-4 *	1,3,4 10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4) A 61 B G 10 K												
P,A	EP-A-0 097 917 (SIEMENS AG) * Abrégé; page 5, ligne 22 - page 6, ligne 3; page 6, ligne 32 - page 7, ligne 5; page 8, lignes 17-27; figures 1,2 *	1-3,6 11													
---		-/-													
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications															
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 08-01-1985	Examineur RIEB K.D.												
<table border="0"><tr><td>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</td><td>T : théorie ou principe à la base de l'invention</td></tr><tr><td>X : particulièrement pertinent à lui seul</td><td>E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date</td></tr><tr><td>Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie</td><td>D : cité dans la demande</td></tr><tr><td>A : arrière-plan technologique</td><td>L : cité pour d'autres raisons</td></tr><tr><td>O : divulgation non-écrite</td><td></td></tr><tr><td>P : document intercalaire</td><td>& : membre de la même famille, document correspondant</td></tr></table>				CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES	T : théorie ou principe à la base de l'invention	X : particulièrement pertinent à lui seul	E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date	Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie	D : cité dans la demande	A : arrière-plan technologique	L : cité pour d'autres raisons	O : divulgation non-écrite		P : document intercalaire	& : membre de la même famille, document correspondant
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES	T : théorie ou principe à la base de l'invention														
X : particulièrement pertinent à lui seul	E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date														
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie	D : cité dans la demande														
A : arrière-plan technologique	L : cité pour d'autres raisons														
O : divulgation non-écrite															
P : document intercalaire	& : membre de la même famille, document correspondant														



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS							
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)				
A	DE-A-3 219 118 (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) * Abrégé; page 6, lignes 14-24; page 9, lignes 1-37; page 11, lignes 17-27; figures 1-4 *	7,8,10 ,12,13 ,15					
A	FR-A-2 356 143 (SUTURES, INC.) * Page 9, ligne 20 - page 10, ligne 1; figures 2a-2c *	8-10					
A	EP-A-0 028 825 (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) * Abrégé; page 3, lignes 5-20; page 4, lignes 10-25; page 6, ligne 34 - page 7, ligne 3; page 7, lignes 21-26; page 8, lignes 5-19; page 9, lignes 5-11; figures 1-4 *	7,12-15					
A	FR-A-2 424 733 (I.N.S.E.R.M.) * Page 2, ligne 34 - page 3, ligne 12; page 4, lignes 6-14; figure 1 *	6,13,16					
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)				
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 08-01-1985	Examineur RIEB K.D.				
<table><tr><td>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</td><td>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</td></tr><tr><td>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</td><td></td></tr></table>				CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES	T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES	T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant						
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire							

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)